



licitação chapada <licitachapada@gmail.com>

Re: PE 12018 - 989059 - prefeitura - ESCLARECIMENTOS

2 mensagens

Saude Chapada <saudechapa@gmail.com>

23 de julho de 2018 11:16

Para: Luiz Sabino <luiz.sabino@kientro.com.br>, licitação chapada <licitachapada@gmail.com>, dra.patriciadourado.neves@gmail.com, rodrigo santos <rodrigoguimaraescba@gmail.com>

Bom dia,

Em resposta ao questionamento sobre o *"Item 28 : Carro para Transporte de Cadáveres"*, informamos que aceitaremos a mudança para carro inox, desde que não altere o valor máximo proposto no edital.

Obrigado

Rubens Ranzani

Em 19 de julho de 2018 15:15, Luiz Sabino <luiz.sabino@kientro.com.br> escreveu:

Prezados senhores boa tarde!

Respeitosamente e em tempo solicitamos esclarecimentos para o item 28 do ANEXO I – SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA:

O descritivo em edital menciona as seguintes característica para o carro cadáver:

"Item 28 : Carro para Transporte de Cadáveres, Estrutura construída em tubos de aço carbono ASTM A36 DE 1 ¼", com tratamento antiferruginoso e acabamento em Pintura Eletrostática a Pó Epóxi. Leito em aço inox AISI 304, com procedência e certificação, com rebaixo para reter líquidos com tubo de escoamento. Pés com rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Dimensões: 0,60 x 1,90 x 0,80."

questionamos se será admitido a descrição abaixo e conforme imagem em abaixo:

Item 28

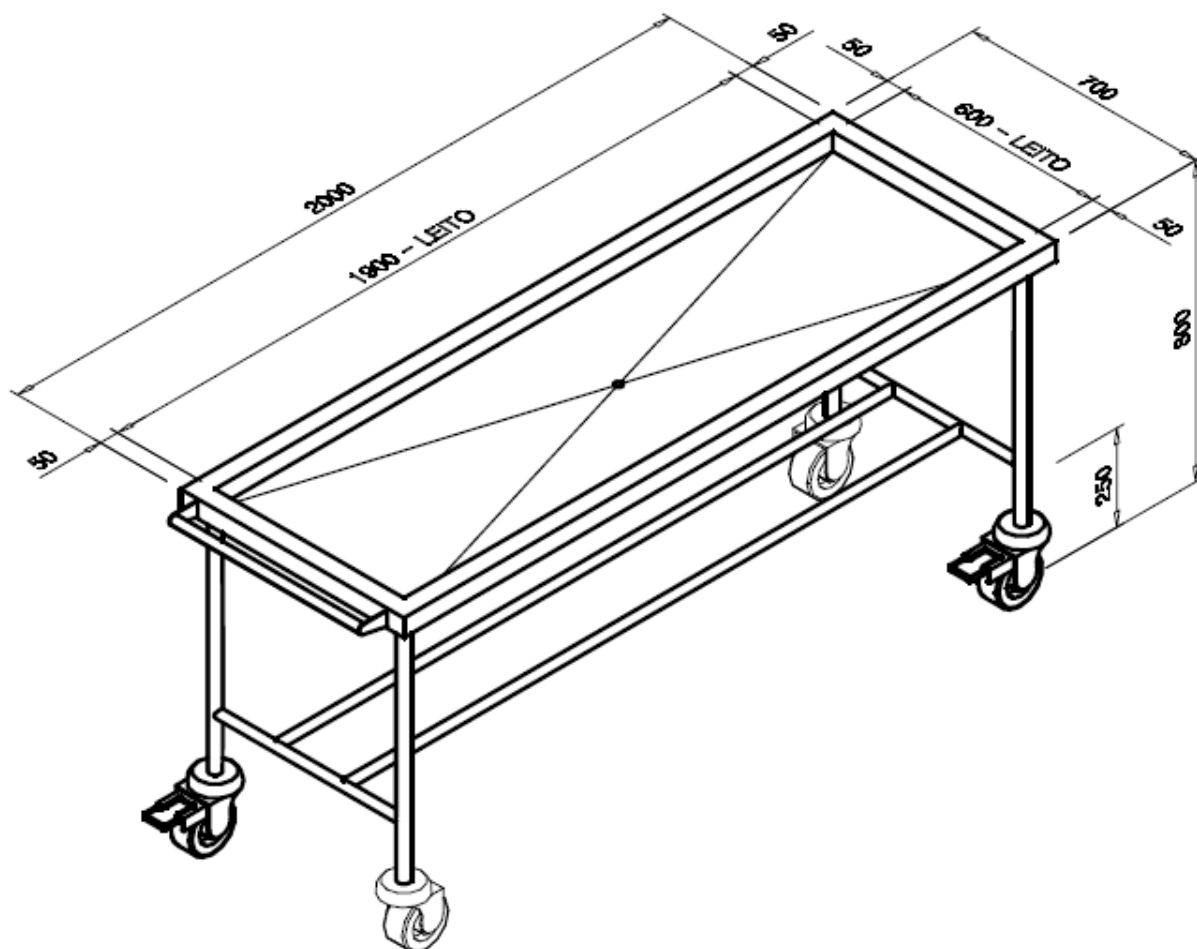
Carro para Transporte de Cadáveres*Estrutura construída em tubos de aço inox*

Leito em aço inox AISI 304, com procedência e certificação,
com rebaixo para reter líquidos com tubo de escoamento.

Pés com rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal.

Dimensões: 0,60 x 1,90 x 0,80 m

A única mudança seria que o carro todo seria em aço inox, ou seja superior ao solicitado.

**NOTAS:**

- Leito fixo construído em chapa inox AISI 430 #20 USG
- Estrutura em tubos em aço inox 304 Ø32mm
- Contraventamento em tubo inox AISI 304 Ø25mm

Obrigado!

atenciosamente;

Luiz Sabino

Kientro Brasil Ltda

CNPJ: 19.717.870/0001-04

Fone (19) 3022-6045



Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o **MEIO AMBIENTE!**

licitação chapada <licitachapada@gmail.com>
Para: luiz.sabino@kientro.com.br

24 de julho de 2018 09:48

Bom Dia,

Prezado Licitante,

Em resposta, a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde informou que será aceita a mudança para carro inox, desde que não altere o valor máximo proposto no edital.

Sendo o que nos era cumprido a informar, desde já agradecemos e estamos a disposição para esclarecimentos adicionais.

Att.,

Luíz Sávio F. de Campos
Pregoeiro Oficial

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Saude Chapada** <saudechapa@gmail.com>

Data: 23 de julho de 2018 11:16

Assunto: Re: PE 12018 - 989059 - prefeitura - ESCLARECIMENTOS

Para: Luiz Sabino <luiz.sabino@kientro.com.br>, licitação chapada <licitachapada@gmail.com>, dra.patriciadourado.neves@gmail.com, rodrigo santos <rodrigoguimaraescba@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
TELEFONE- 65-3301-1570**